

Autosampler schließen eine wichtige Lücke in der Routineanalytik. Sie automatisieren die Probenaufgabe und je nach Ausstattung auch die Probenvorbereitung.

Seite 32

KITS & ARRAYS

Elisa-Test zum Nachweis von Mykoplasma bovis

58

E. SCHECKLIES, R. HOFSTETTER,
S. FRISCHMANN

PROZESSANALYTIK

Wasserstoff-Speicherung in Materialien bestimmen

62

F. DREISBACH


MARKTÜBERSICHT: AA-SPETKROMETER

Elementbestimmung – schnell und empfindlich

66

Firmenübersicht AA-Spektrometer

68

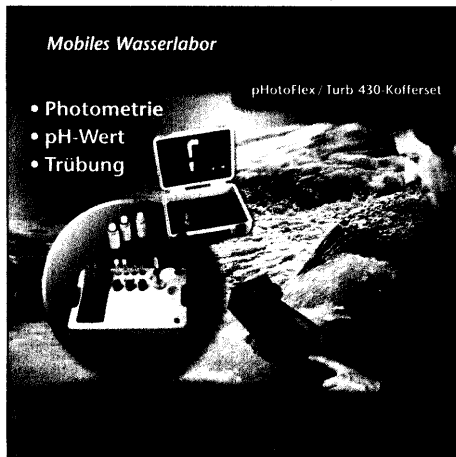


Mobiles Wasserlabor

pHotoFlex/ Turb 430 Kofferset

- Photometrie
- pH-Wert
- Trübung

akku-drive®

Seriendosieren mit höchster Präzision.

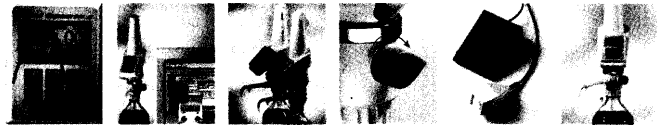

Seriendosieren leicht gemacht

- bis zu 999x perfekte Reproduzierbarkeit
- Zeitintervalle wählbar

Anschluss an die Zukunft

- Eingabe eines individuellen Kalibrierfaktors
- kalibrieren, steuern und protokollieren

Passt immer

- 20 ml und 50 ml Version erhältlich
- Module passen in beide Größen

Rückführsystem


- umweltfreundlich
- budgetschonend

Fernbedienbar

- für ermüdungsfreies Arbeiten
- über Hand- oder Fußtaster

360° Rotation

- frei drehbar
- alles im Blick

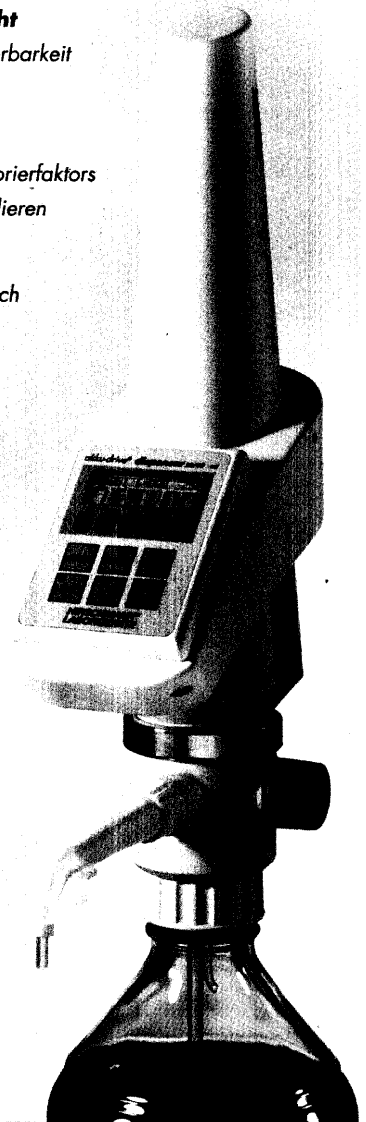

akku-drive® HiClass im Dosieren

Dieses und weitere HiLights fürs Pipettieren, Titrieren und Dosieren finden Sie unter www.hirschmann-laborgeraete.de
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.KG, D-74246 Eberstadt,
Tel. +49(0)7134/511-0, Fax +49(0)7134/511-90